


| | | | | |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| CG.1 | Hip Prosthesis Tray | Gaveta para Prótesis de Cadera | Cassetta per Protesi de Anca | Gaveta para Prótese de Quadril |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|

| Code | Qty. | Description | Descripción | Descrizione | Descrição |
|----------|------|---|---|--|---|
| 8281.A | 1 | Baumer Original Chuck | Mandril Original Baumer | Mandrino Originale Baumer | Mandril Original Baumer |
| 8289.7 | 1 | Reamer to Diaphysis - 7mm | Fresa Diafisaria - 7mm | Fresa Diafisaria - 7mm | Fresa Diafisária - 7mm |
| 8289.8 | 1 | Reamer to Diaphysis - 8mm | Fresa Diafisaria - 8mm | Fresa Diafisaria - 8mm | Fresa Diafisária - 8mm |
| 8289.9 | 1 | Reamer to Diaphysis with Cutting Tip - 9mm | Fresa Diafisaria con punta cortante - 9mm | Fresa Diafisaria con punta tagliente - 9mm | Fresa Diafisária com ponta cortante - 9mm |
| 8289.9.E | 1 | Reamer to Diaphysis without Cutting Tip - 9mm | Fresa Diafisaria sin punta cortante - 9mm | Fresa Diafisaria senza punta tagliente - 9mm | Fresa Diafisária sem ponta cortante -9mm |
| 8289.10 | 1 | Reamer to Diaphysis - 10mm | Fresa Diafisaria - 10mm | Fresa Diafisaria - 10mm | Fresa Diafisária - 10mm |
| 8289.11 | 1 | Reamer to Diaphysis - 11mm | Fresa Diafisaria - 11mm | Fresa Diafisaria - 11mm | Fresa Diafisária - 11mm |
| 8289.12 | 1 | Reamer to Diaphysis - 12mm | Fresa Diafisaria - 12mm | Fresa Diafisaria - 12mm | Fresa Diafisária - 12mm |
| 8289.13 | 1 | Reamer to Diaphysis - 13mm | Fresa Diafisaria - 13mm | Fresa Diafisaria - 13mm | Fresa Diafisária - 13mm |
| 8289.14 | 1 | Reamer to Diaphysis - 14mm | Fresa Diafisaria - 14mm | Fresa Diafisaria - 14mm | Fresa Diafisária - 14mm |
| 8289.15 | 1 | Reamer to Diaphysis - 15mm | Fresa Diafisaria - 15mm | Fresa Diafisaria - 15mm | Fresa Diafisária - 15mm |
| 8289.16 | 1 | Reamer to Diaphysis - 16mm | Fresa Diafisaria - 16mm | Fresa Diafisaria - 16mm | Fresa Diafisária - 16mm |
| 8289.17 | 1 | Reamer to Diaphysis - 17mm | Fresa Diafisaria - 17mm | Fresa Diafisaria - 17mm | Fresa Diafisária - 17mm |
| 8289.18 | 1 | Reamer to Diaphysis - 18mm | Fresa Diafisaria - 18mm | Fresa Diafisaria - 18mm | Fresa Diafisária - 18mm |
| 8289.19 | 1 | Reamer to Diaphysis - 19mm | Fresa Diafisaria - 19mm | Fresa Diafisaria - 19mm | Fresa Diafisária - 19mm |
| 8290 | 1 | Top Reamer | Fresa de Tope | Fresa com Taglio di testa | Fresa de topo |
| 8305 | 1 | "T" Handle | Llave "T" | Chiave a "T" | Chave "T" |

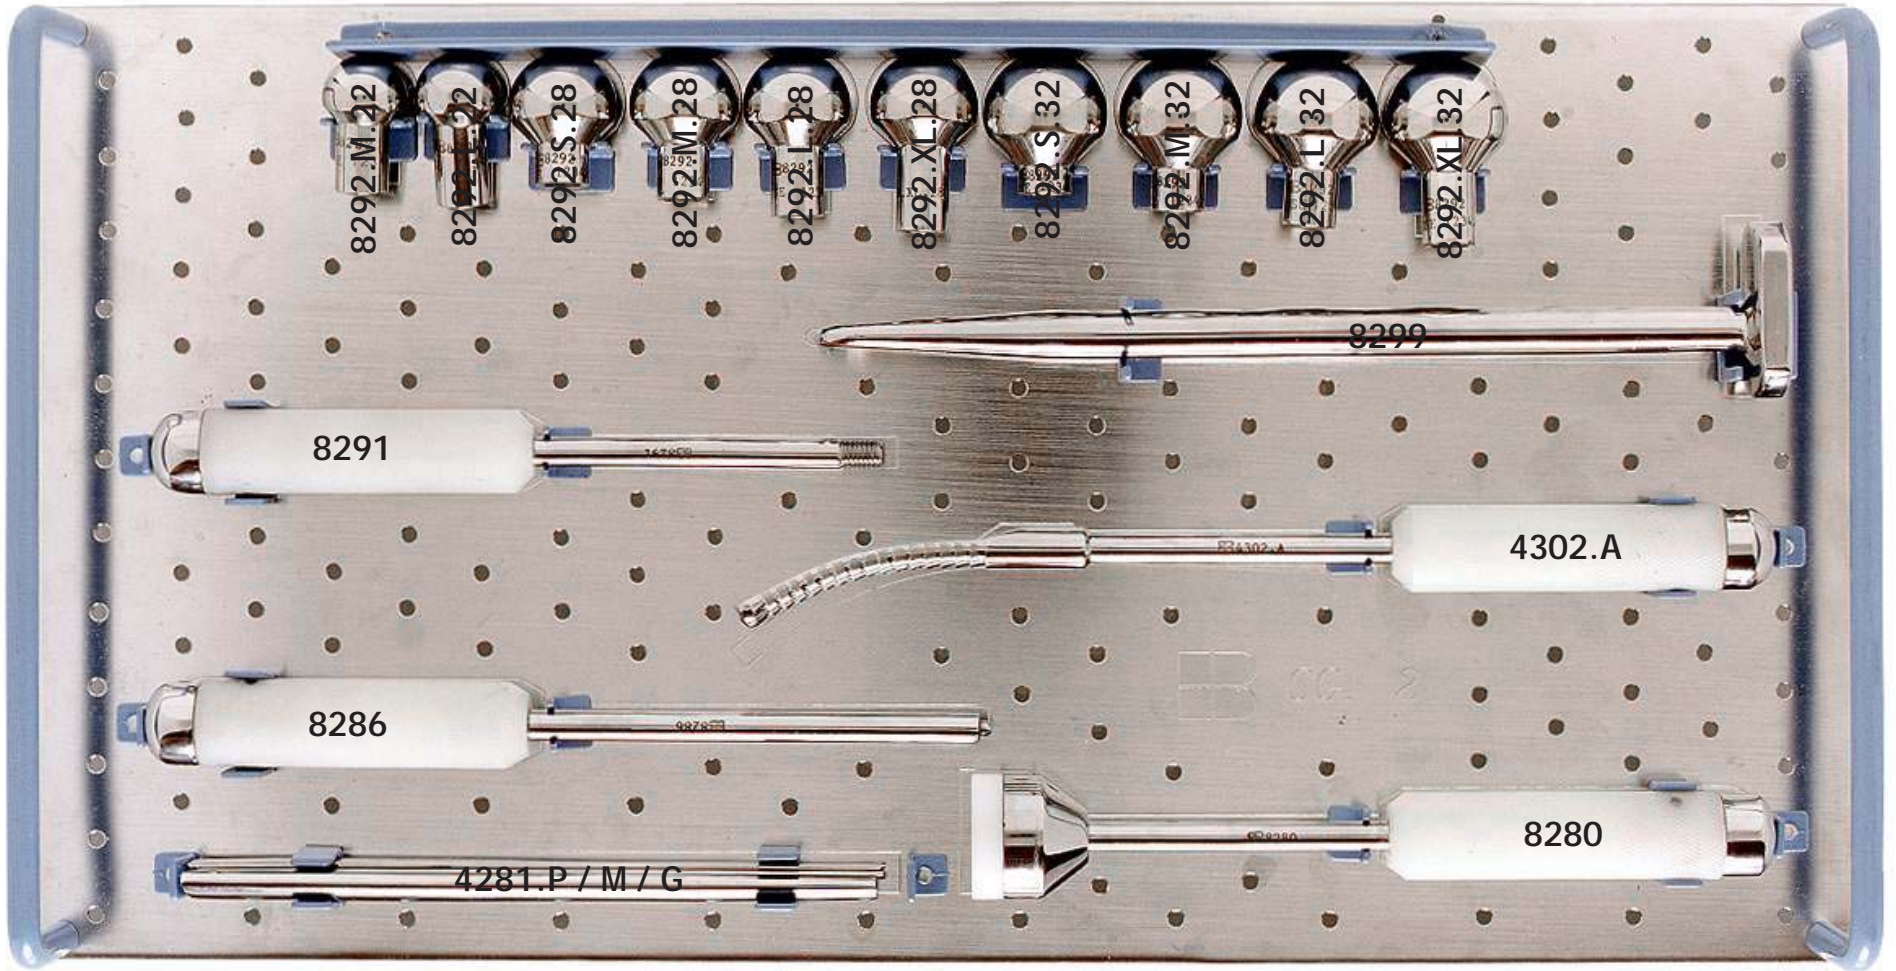

CG.2


Hip Prosthesis Tray

Gaveta para Prótesis de Cadera

Cassetta per Protesi de Anca

Gaveta para Prótese de Quadril

| Code | Qty. | Description | Descripción | Descrizione | Descrição |
|------------|------|----------------------------------|--|---|--|
| 4281.G | 1 | Graft Stamper - Large | Calcador de Injerto Grande | Battitore di Innesto Grande | Calcador de Enxerto Grande |
| 4281.M | 1 | Graft Stamper - Medium | Calcador de Injerto Mediano | Battitore de innesto Medio | Calcador de Enxerto Médio |
| 4281.P | 1 | Graft Stamper - Small | Calcador de Injerto Pequeño | Battitore de Innesto Piccolo | Calcador de Enxerto Pequeno |
| 4302.A | 1 | Curved Rasp | Raspador Curvo | Raspatore Curvo | Raspador Curvo |
| 8280 | 1 | Head Impactor | Impactor de Cabeza | Martelletto della Testa | Imapctor de Cabeça |
| 8286 | 1 | Prost Impactor | Impactor de Prótesis | Martelletto della Protesi | Impactor de Prótese |
| 8291 | 1 | Standard Handle | Cabo Patrón | Punta Padrone | Cabo Padrão |
| 8292.M.22 | 1 | Femoral Head Test-Medium - 22mm | Test de Cabeza Fem. Mediano - 22mm | Test della Testa di Femore Medio - 22mm | Teste de Cabeça Femoral Médio - 22mm |
| 8292.L.22 | 1 | Femoral Head Test-Long - 22mm | Test de Cabeza Fem. Largo - 22mm | Test della Testa di Femore Lungo - 22mm | Teste de Cabeça Femoral Longo - 22mm |
| 8292.S.28 | 1 | Femoral Head Test-Short - 28mm | Test de Cabeza Fem. Corto - 28mm | Test della Testa di Femore Corta - 28mm | Teste de Cabeça Femoral Curto - 28mm |
| 8292.M.28 | 1 | Femoral Head Test-Medium - 28mm | Test de Cabeza Fem. Mediano - 28mm | Test della Testa di Femore Medio - 28mm | Teste de Cabeça Femoral Médio - 28mm |
| 8292.L.28 | 1 | Femoral Head Test-Long - 28mm | Test de Cabeza Fem. Largo - 28mm | Test della Testa di Femore Lungo - 28mm | Teste de Cabeça Femoral Longo - 28mm |
| 8292.XL.28 | 1 | Femoral Head Test-Ex.Long - 28mm | Test de Cabeza Fem. Extra Largo - 28mm | Test della Testa di Femore Extra Lungo - 28mm | Teste de Cabeça Femoral Extra Longo - 28mm |
| 8292.S.32 | 1 | Femoral Head Test-Short - 32mm | Test de Cabeza Fem. Corto - 32mm | Test della Testa di Femore Corta - 32mm | Teste de Cabeça Femoral Curto -32mm |
| 8292.M.32 | 1 | Femoral Head Test-Medium - 32mm | Test de Cabeza Fem. Mediano - 32mm | Test della Testa di Femore Medio - 32mm | Teste de Cabeça Femoral Médio - 32mm |
| 8292.L.32 | 1 | Femoral Head Test-Long - 32mm | Test de Cabeza Fem. Largo - 32mm | Test della Testa di Femore Lungo - 32mm | Teste de Cabeça Femoral Longo - 32mm |
| 8292.XL.32 | 1 | Femoral Head Test-EX.Long - 32mm | Test de Cabeza Fem. Extra Largo - 32mm | Test della Testa di Femore Extra Lungo - 32mm | Teste de Cabeça Femoral Extra Longo - 32mm |
| 8299 | 1 | Prosthesis Extractor | Extractor de la Prótesis | Estrattore della Protesi | Extrator da Prótese |

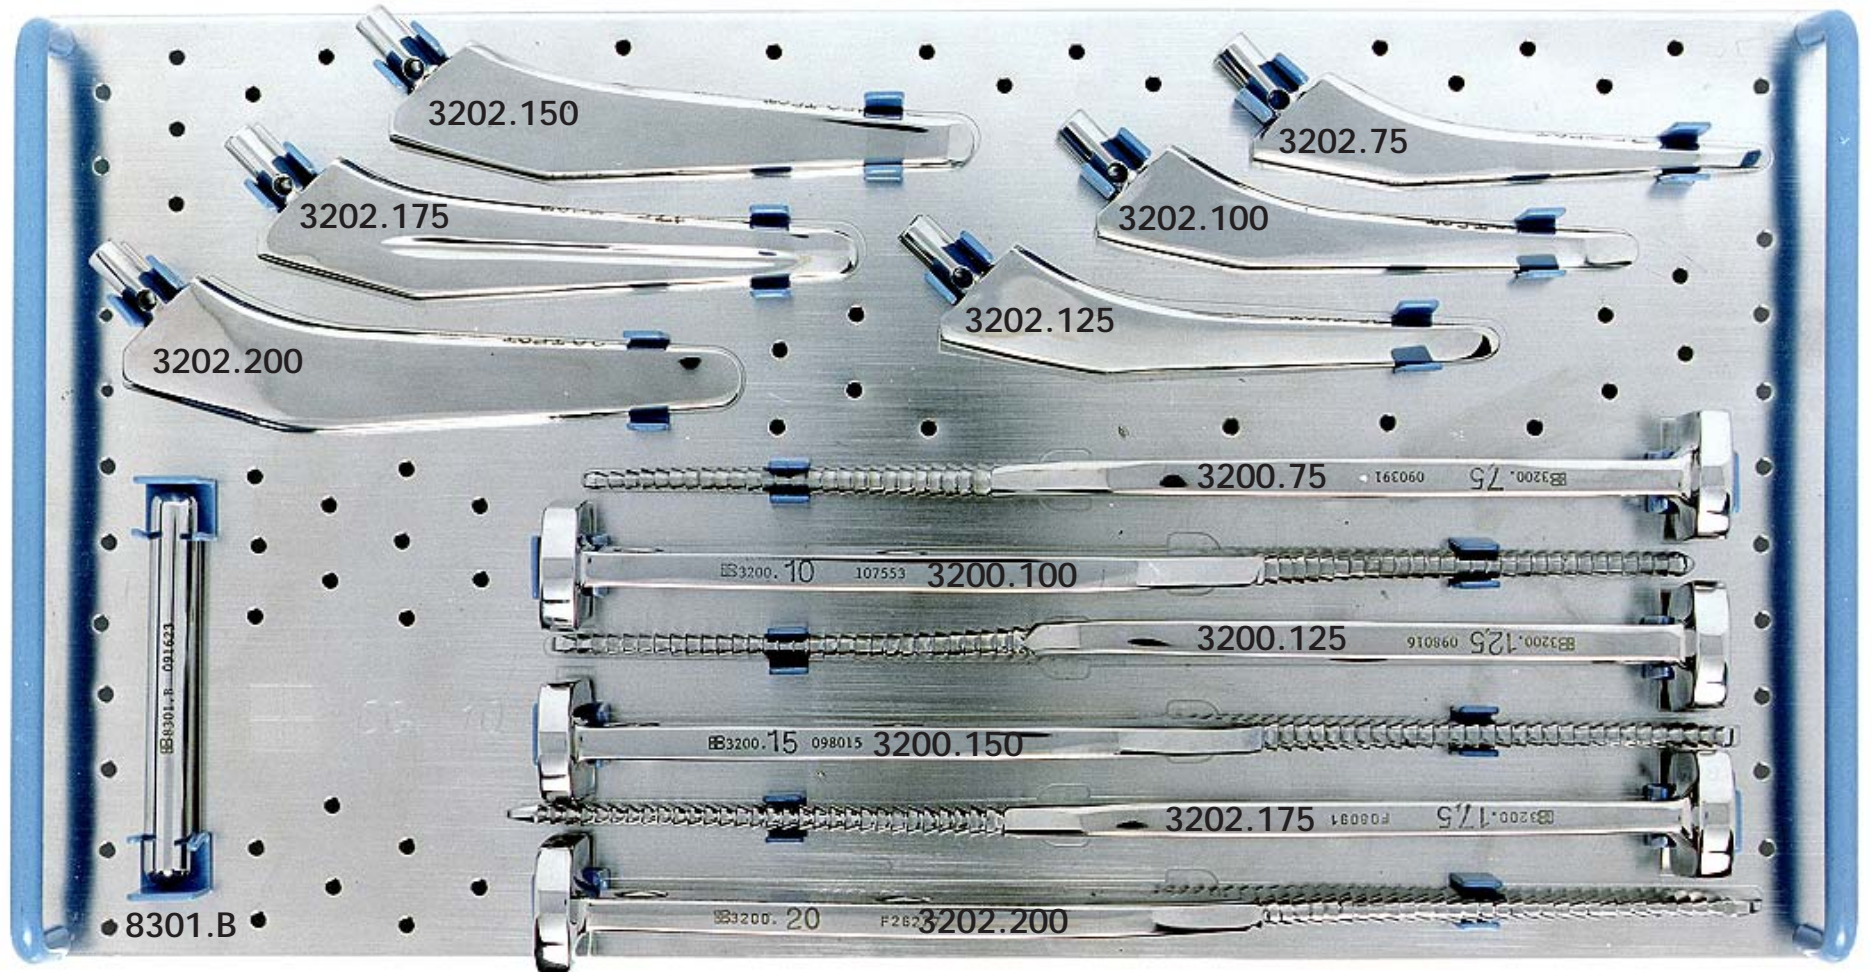

CG.10

Müller Prosthesis Tray

Gaveta para Prótesis de Müller

Cassetta per Protesi di Muller

Gaveta para Próteses de Müller

| Code | Qty. | Description | Descripción | Descrizione | Descrição |
|----------|------|---------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 3200.75 | 1 | Müller Prosthesis Rasp - 7,5mm | Raspador de Prótesis Müller - 7,5mm | Raschiatore della Protesi di Muller - 7,5mm | Raspador de Prótese Müller - 7,5mm |
| 3200.100 | 1 | Müller Prosthesis Rasp - 10mm | Raspador de Prótesis Müller - 10mm | Raschiatore della Protesi di Muller - 10mm | Raspador de Prótese Müller - 10mm |
| 3200.125 | 1 | Müller Prosthesis Rasp - 12,5mm | Raspador de Prótesis Müller - 12,5mm | Raschiatore della Protesi di Muller - 12,5mm | Raspador de Prótese Müller - 12,5mm |
| 3200.150 | 1 | Müller Prosthesis Rasp - 15mm | Raspador de Prótesis Müller - 15mm | Raschiatore della Protesi di Muller - 15mm | Raspador de Prótese Müller - 15mm |
| 3200.175 | 1 | Müller Prosthesis Rasp - 17,5mm | Raspador de Prótesis Müller - 17,5mm | Raschiatore della Protesi di Muller - 17,5mm | Raspador de Prótese Müller - 17,5mm |
| 3200.200 | 1 | Müller Prosthesis Rasp - 20mm | Raspador de Prótesis Müller - 20mm | Raschiatore della Protesi di Muller - 20mm | Raspador de Prótese Müller - 20mm |
| 3202.75 | 1 | Müller Prosthesis Test - 7,5mm | Test de la Prótesis de Müller - 7,5mm | Test della Protesi di Muller - 7,5mm | Teste da Prótese Müller - 7,5mm |
| 3202.100 | 1 | Müller Prosthesis Test - 10mm | Test de la Prótesis de Müller - 10mm | Test della Protesi di Muller - 10mm | Teste da Prótese Müller - 10mm |
| 3202.125 | 1 | Müller Prosthesis Test - 12,5mm | Test de la Prótesis de Müller - 12,5mm | Test della Protesi di Muller - 12,5mm | Teste da Prótese Müller - 12,5mm |
| 3200.150 | 1 | Müller Prosthesis Test - 15mm | Test de la Prótesis de Müller - 15mm | Test della Protesi di Muller - 15mm | Teste da Prótese Müller - 15mm |
| 3202.175 | 1 | Müller Prosthesis Test - 17,5mm | Test de la Prótesis de Müller - 17,5mm | Test della Protesi di Muller - 17,5mm | Teste da Prótese Müller - 17,5mm |
| 3202.200 | 1 | Müller Prosthesis Test - 20mm | Test de la Prótesis de Müller - 20mm | Test della Protesi di Muller - 20mm | Teste da Prótese Müller - 20mm |
| 8301.B | 1 | Rasp Extractor Pin | Espiga Extracción del raspador | Estrattore del Raschiatore | Pino para Extração do Raspador |